

(Pracovní postup č. PP-Řd-004-08-08, 2. vydání ze dne 22. 9. 2023)



Obsah školení pracovníků

- **Kultivační boxy** (Heracell 150i vlevo, HeraCell 150i vpravo, Labotec C60, K-SYSTÉM, MIRI TL12) mají zabudován automatický hlásič poruchy (teplota, CO₂).
- **Dewarovy nádoby** mají zabudovanou kontrolu hladiny tekutého dusíku a uzavření víka.
- **Lednice na kritická média** má zabudovanou kontrolu teploty.
- Při dosažení jiných než nastavených teplot dojde k akustickému upozornění na uvedenou poruchu.

a) **V pracovní době (pondělí až pátek 6:30 – 15:30):**

- havarijnú situáciu rieši prítomní pracovníci CAR
- b) **Mimo pracovnú dobu:**
 - Systém ConWin zašle varovnú SMS jednak na telefón stálej ambulantnej služby a tiež na služebný telefón pracovníkom CAR.
 - Službu konajúci pracovník PORGYN ambulantnej služby v prípade havárie postupuje dle tohto pracovného postupu.
- c) Službu konajúci pracovník PORGYN kontaktuje firmu CONDATA a riadi sa jeho pokynmi.
- d) Nedojde-li k odstráneniu problému, kontaktuje službu konajúci pracovník PORGYN embryologa CAR.
- e) Po telefonickom konzultácii postupuje službu konajúci pracovník PORGYN dle typu havárie podľa tohto pracovného postupu.

[illegible][illegible]

Strana 1/7


Postup při řešení havarijní situace v Centru asistované reprodukce

(Pracovní postup č. PP-Řd-004-08-08, 2. vydání ze dne 22. 9. 2023)




Příloha č. 2 PP-Řd-004-08-08-2

5. Vyhodnocení grafu

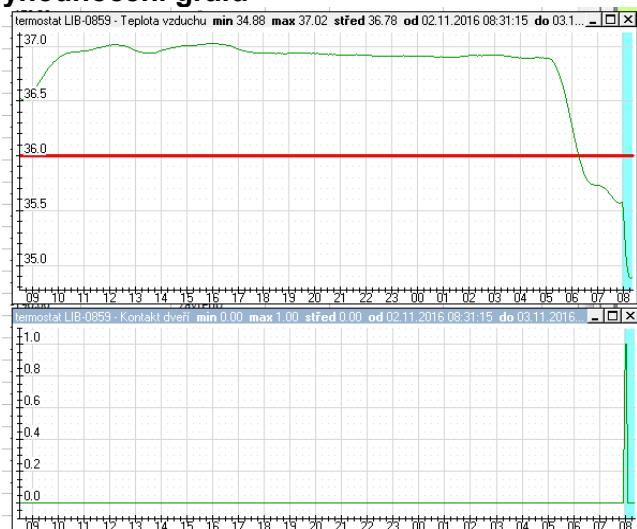

6. Schéma procesu řešení havarijní situace

a) Výpadek systému CONDATA a okruhů

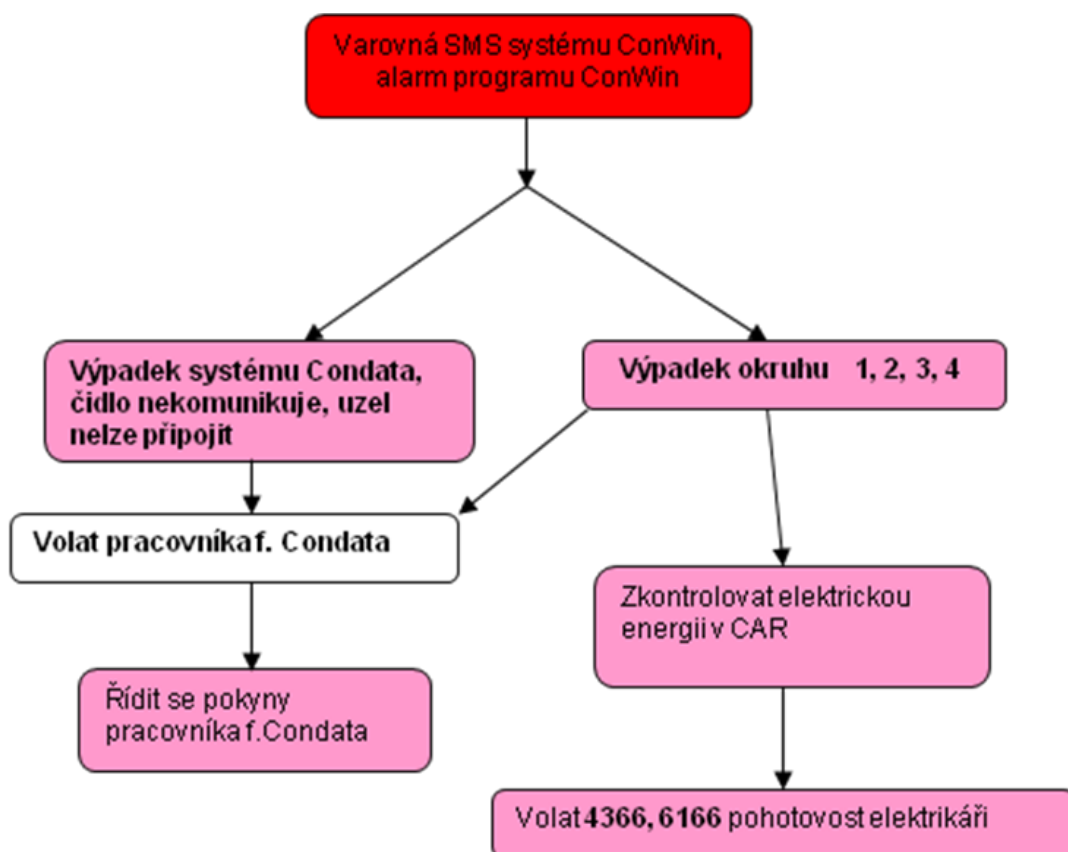


Postup při řešení havarijní situace v Centru asistované reprodukce

(Pracovní postup č. PP-Řd-004-08-08, 2. vydání ze dne 22. 9. 2023)



Příloha č. 2 PP-Řd-004-08-08-2

b) Kryosklad

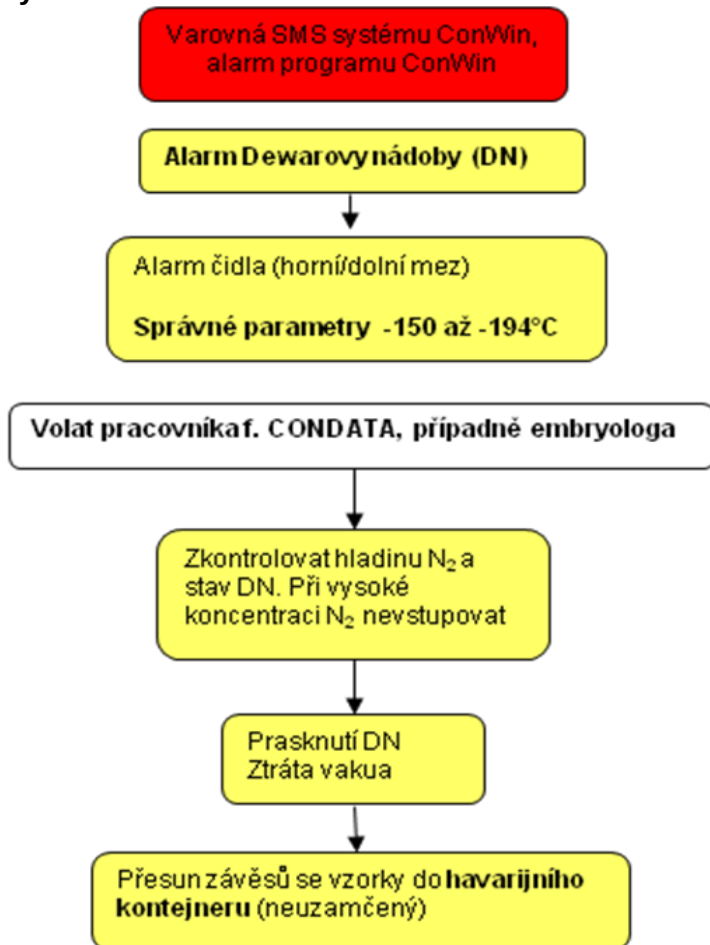

Skříňka na klíče k DN



Havarijní kontejner

Není-li tento výtisk na první straně opatřen originálními podpisy, je **NEŘÍZENOU KOPIÍ**.


Postup při řešení havarijní situace v Centru asistované reprodukce

(Pracovní postup č. PP-Řd-004-08-08, 2. vydání ze dne 22. 9. 2023)



Příloha č. 2 PP-Řd-004-08-08-2

c) Lednice v embryologické laboratoři

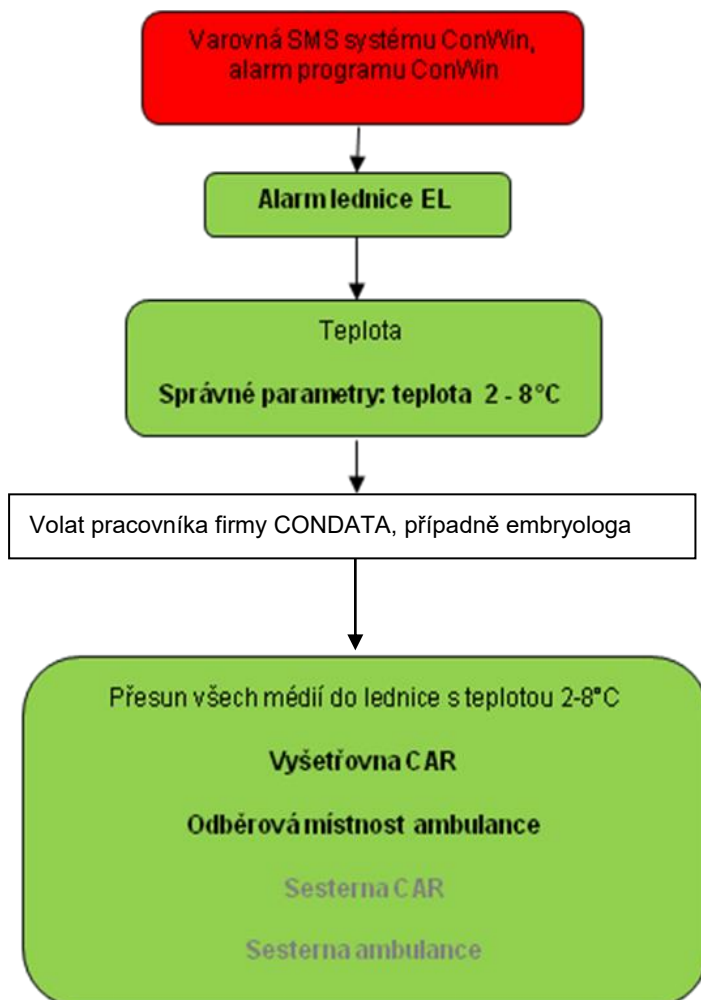


Postup při řešení havarijní situace v Centru asistované reprodukce

(Pracovní postup č. PP-Řd-004-08-08, 2. vydání ze dne 22. 9. 2023)



Příloha č. 2 PP-Řd-004-08-08-2

d) Inkubátory v embryologické laboratoři

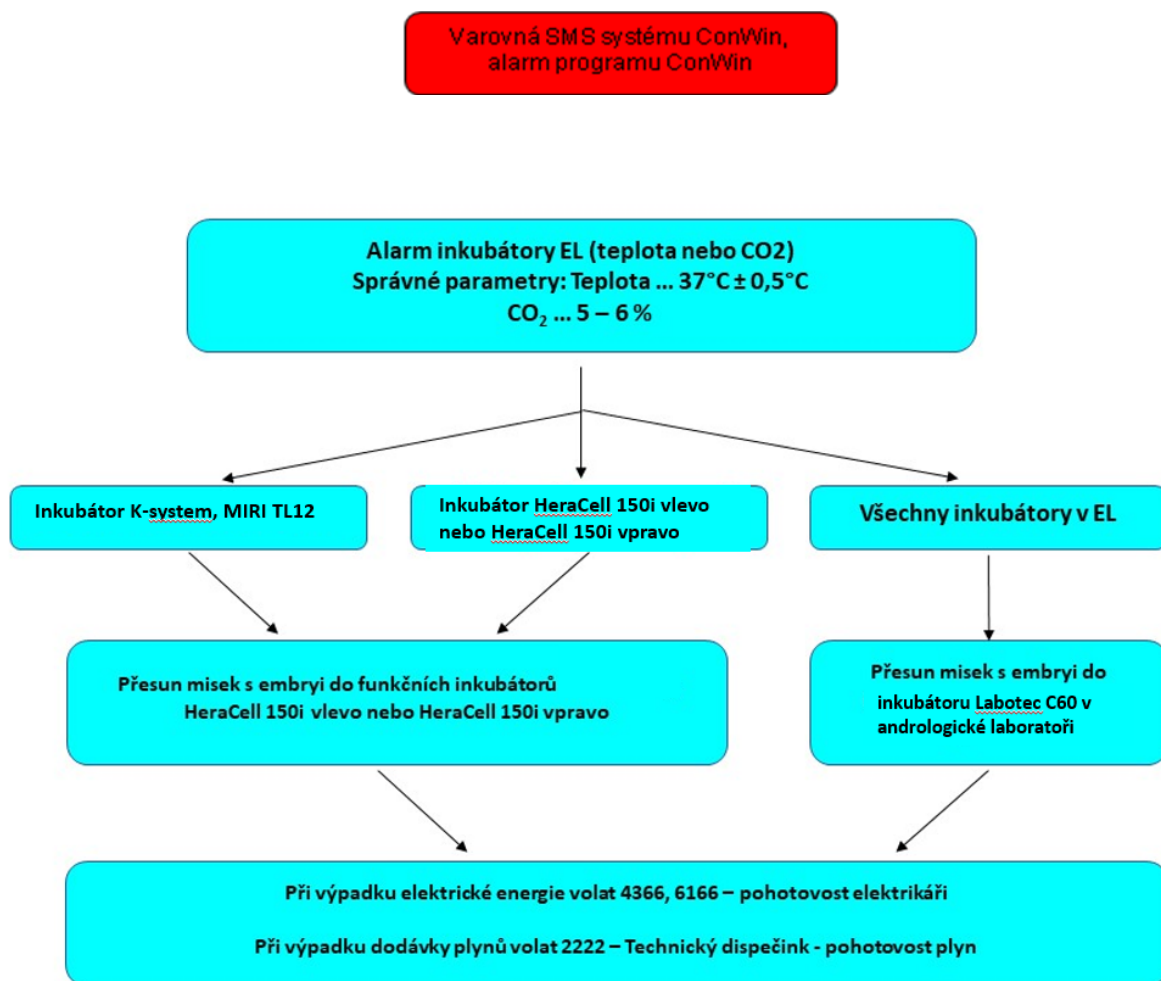

Postup při řešení havarijní situace v Centru asistované reprodukce

(Pracovní postup č. PP-Řd-004-08-08, 2. vydání ze dne 22. 9. 2023)



Příloha č. 2 PP-Řd-004-08-08-2



Postup při řešení havarijní situace v Centru asistované reprodukce

(Pracovní postup č. PP-Řd-004-08-08, 2. vydání ze dne 22. 9. 2023)



Příloha č. 2 PP-Řd-004-08-08-2

e) Inkubátory – andrologická laboratoř



Tato příloha nepodléhá připomínkovému řízení.