

Martin Bičíš - BIČELS, Resslova 890, 500 02 Hradec Králové
DIČ: CZ6404282192, IČO: 15591051, Číslo účtu 21397/0300
tel. 495 217 192 fax. 495 213 213
Ministerstvo zdravotnictví C.j.: 6180A/02 - servis, os.pověř.

BEZPEČNOSTNĚ-TECHNICKÁ KONTROLA ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU

Typ přístroje: Dávkovače Graseby 3100 II.b	Výrobní číslo : 36540 Invent. číslo: IO18081-000 ID:	Uživatel: Fakultní nemocnice Olomouc dispečink oprav I.P.Pavlova 6 77520 OLOMOUC Oddělení: III.Interna JIP 0331
--	---	---

Bezpečnostně-technická prohlídka je prováděna v souladu s návodem k použití a servisním návodem.
Použity výhradně kalibrované servisní pomůcky a měřicí přístroje.

Všechny naměřené hodnoty musí být dokumentovány. Přísluš. a dokumentace musí být uvedena ve zkušebním protokolu.

Kontrolovat	Zjištěné nedostatky	Poznámky	Potvrzení
Kryt			OK
Klávesnice-folie/ovládací prvky			OK
Síťová zásuvka a kabel			OK
Svěrka			OK
Baterie /akum./-záložní zdroj			OK
Nožičky			OK
Snímač tlaku			OK
Snímač založení stříkačky			OK
Dokumentace			OK
Funkční zkouška			---

Průběh testu			OK
Zvukový-optický signál			OK
Reakce přístroje na vyvoditelné alarmy			OK
Okluzní tlak			OK
Kontrola kapacity akumulátoru			OK
Signalizace displeje, indik. prvku			OK
Test-umlčení alarmu			OK
Kontrola rychlosti dávkování			OK
Přepínání stříkačky			OK

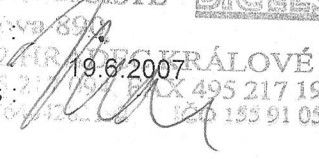

Zkouška elektrické bezpečnosti dle ČSN EN 60601

Síťové nap. 230 V	Odpor ochr.vodiče vč.kabelu : --- Ω	Unikající proud : /PE 0.005 mA
----------------------	--	-----------------------------------

Výsledek kontroly

Zařízení je schopno bezpečného provozu:	ANO
Pokud NE - důvod:	

Výše uvedený zdravotnický prostředek splňuje ustanovení par.27,28 a 52, zákona č.123/2000 Sb.

Datum příští kontroly: 18.6.2008	Kontrolu provedl: MARTIN BIČÍŠ - BIČELS Datum : 19.6.2007 Podpis : 	Přístroj předán: Datum: 29-06-2007 Podpis : 
--	--	--

Použité měřicí přístroje:

Digitální tlakoměr CRESSTO DMU-R 1000, v.č. 2842/06
Analyzátor elektrických zařízení RM2051, v.č. 401174