


ACCU-CHEK® Inform



Dne: 2.12.2008

byla provedena kontrola systému na stanovení glukózy AccuChek Inform. Hodnota testu je uvedena v příložené tabulce a grafu.

NEH YIP

Číslo AccuChek Inform:


VY50012788

LOT testovacích proužků:

450764

LOT Kitu Linearity:

80300

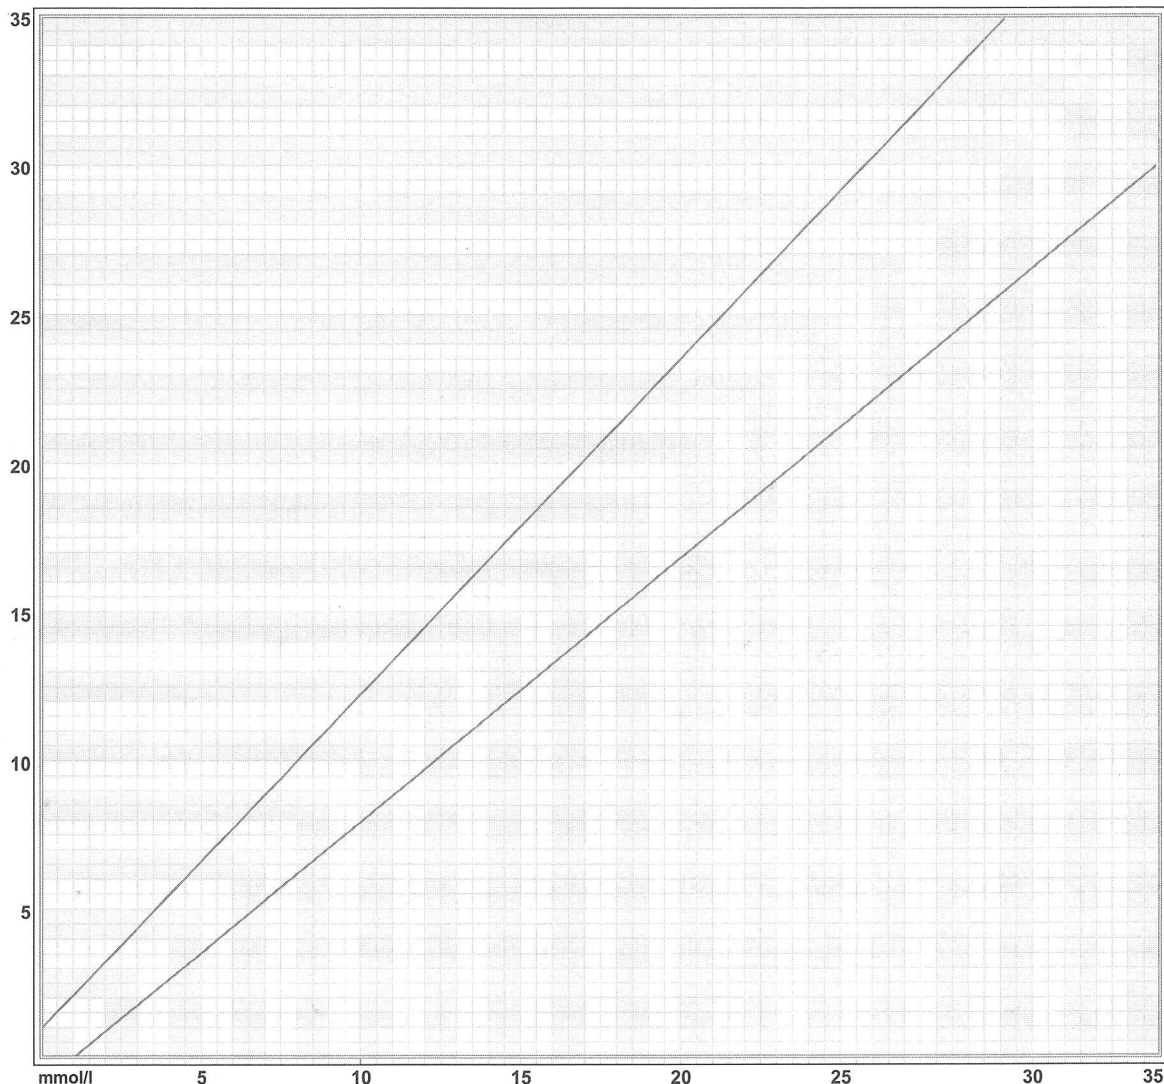

1,9	3,2	6,9	16,6	25,5	26,7	
Výsledek						
Cílová hodnota						

Test linearity byl uznán jako:

VYHOVUJÍCÍ



NEVYHOVUJÍCÍ



Servisní test byl ohodnocen jako:

VYHOVUJÍCÍ



NEVYHOVUJÍCÍ



Byl proveden upgrade systému na verzi firmware:

Potvrzení vydal:



ROCHE s.r.o.
Dukelských hrdinů 52, 170 00 Praha 7
DIČ: 007-49617052
IČO: 49617052

