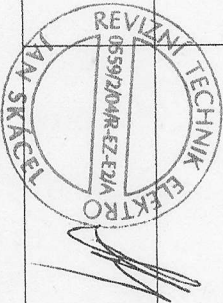


Fakturační adresa: Jan Skácel Ječmínkova 24 724 00 Ostrava Stará Bělá IČO: 633 06 743 DIČ:CZ 54 01 30 31 05 Tel: 603 181 006		PROTOKOL o revizi (kontrola) elektrického zdravotnického přístroje (el.spotřebiče)dle doporučení ČES 33.03.95 a ČSN 33 16 00.ČSN 33 16 10.ČSN EN 60950-1 BTK – bezpečnostně.technická kontrola		Datum:06.03.2008 Jméno technika : Jan Skácel Osobní číslo : 0559/2/04/R-EZ-E2/A Typ měřícího přístroje: Revex profi Výrobní číslo:7080136 Typ měřícího přístroje:RM 2050 Výrobní číslo:4030274 Typ měřícího přístroje: Výrobní číslo:	
Zákazník: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ I.P.Pavlova 6 775 20 Olomouc		Měření elektrických bezpečnostních parametrů: Odpor ochranného vodiče: Rp (Ip = 200 mA).....0,165 Odpor ochranného vodiče: Rp UΔ(Ip = 10 A).....0,15 Isolační odpor R iso (Up= 500V).....100 Proud ochranným vodičem přímá metoda :.....0,08+0,061 Proud ochranným vodičem nepřímá metoda :..... Dotykový proud přímá metoda:..... Dotykový proud rozdílová metoda:..... Náhradní unikající proud mezi síťovou a příložnou částí:.....0,086 Náhradní unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:..... Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:..... Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí s pomocným zdrojem:..... Napájecí napětí:.....226 Napájecí proud:.....0,1 Příkon:..... cos φ :.....			
Umístění spotřebiče:.....neurochirurgická JIP Druh spotřebiče:.. Lůžko nemocniční avantgard 1200 Třída ochrany :.....I.....(I,IIa,IIb,III) Typ/zařazení:.....B,BF,CF Výrobce:.....Hill Room Výrobní číslo:.....MRP000365516 Inv.číslo:.....I 022849-000 Provozní zkouška:.....ano		Stav přístroje: Mechan.-poškození:.....ne..... Přívody:.....v pořádku..... Stav krytů:.....dobrý..... Protokol o poslední revizi:.....ne.....		Revize provedena s výsledkem: Vyhověl Bezp.tech.kontrolaprovedena s výsledkem: Vyhověl Prověřovaný přístroj vyhovuje tech.předpisům podle nichž byl vyroben a je schopen použití v souladu s návodem k použití dle zákona č.346/2003 sb. §52 odst.4.	
Přští revize (kontrola):za rok				Tento protokol má 1 stranu. Počet vyhotovení: 2 Rozdělovník: 1x zákazník 1x revizní technik	