



Tuto kontrolu je třeba provést nejpozději po 12 měsících od poslední bezpečnostně technické kontroly autorizovaným servisem.

Zde neuvedená čísla kontrol nejsou součástí bezpečnostně technické kontroly.

Zhotovitel prohlašuje, že splňuje požadavky národní legislativy potřebné k uvedeným činnostem.

Provedení a výsledek kontroly musí být vyznačeno v provozní knize přístroje.

Technik: Miroslav Kubeš      Umístění: FN Olomouc

Výrobní číslo: 18242884      Inv. číslo: IO20831      Typ přístroje: Module DPS

Upozornění: před bezpečnostně technickou kontrolou plně  
nabijte (16 hodin) akumulátor přístroje      SV č.: CZ

Č.	Procedura	Naměřeno	Stav
1.	Zobrazení ubíhajícího času mezi dvěma BTK (tESt1)	H/J/M	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	Datum poslední údržby (tESt1)	J/M/A	<input checked="" type="checkbox"/>
3.	Celkový čas na displeji (tESt6)	H/J/M	<input checked="" type="checkbox"/>
4.	Kontrola LED (tESt2)		<input checked="" type="checkbox"/>
5.	Kontrola tlačítek klávesnice (tESt3) - (viz. Technický manuál, kapitola 3)		<input checked="" type="checkbox"/>
6.	Kontrola čidla tlaku (tESt9) - překontroluj, zda zobrazená hodnota je mezi 0 a 100g (nezatížené čidlo). - stiskni a uvolni čidlo, zobrazená hodnota musí být mezi 0 a 100g, - pokud ne, viz. kalibrační mód EtAL9		<input checked="" type="checkbox"/>
7.	Kontrola ADC převodníku (tEStb) - vstup 3: hodnota mezi 066≤ 07D LSB≤ 08F zobrazená hodnota-amplituda výstupu (0,6 V + 0,05) pokud je mimo toleranci, viz kalibrační mód EtAL9		<input checked="" type="checkbox"/>
8.	Kontrola čidla polohy (tESt C) - použij kalibr T300775-B nebo T300940E a T300775G horní poloha ..... 114,5≤ 115 mm≤ 115,5 spodní poloha ..... 19,5≤ 20 mm≤ 20,5  Pokud je mimo toleranci, viz kalibrační mód EtAL6		<input checked="" type="checkbox"/>

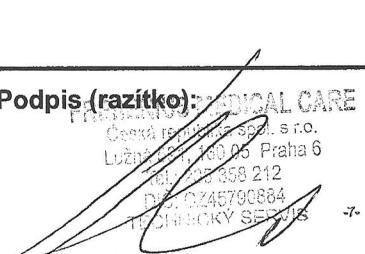
	Kontrola držáku stříkačky (tEStF) pro stříkačku používanou na zařízení - ověř zobrazený typ stříkačky použitím ověřovací pomůcky (VG3: T301453). Pozn.: VG3 znamená: (V) ověřovací pomůcka, (G3) skupina stříkaček č.:3	
9.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- držák stříkačky v horní poloze zobrazeno</li> <li>- nástroj č.1: Max zobrazeno: 50 ccm</li> <li>- nástroj č.1: Mini zobrazeno: 50 ccm</li> <li>- nástroj č.2: Max zobrazeno: 20 ccm</li> <li>- nástroj č.2: Mini zobrazeno: 20 ccm</li> <li>- nástroj č.3: Max zobrazeno: 10 ccm</li> <li>- nástroj č.3: Mini zobrazeno: 10 ccm</li> <li>- nástroj č.4: Max zobrazeno: 5 ccm</li> <li>- nástroj č.4: Mini zobrazeno: 5 ccm</li> <li>- držák stříkačky ve spodní poloze zobrazeno</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	Zobrazená velikost stříkačky má odpovídat použité pomůcce, pokud ne viz „EtAL d“ Kalibraci velikosti stříkačky provádět pomůckami číslo 5, 6 a 7. (CG3: T301452) Pozn.: CG3 znamená: (C) kalibrační pomůcka, (G3) skupina stříkaček č.:3 Pokud je přístroj v kalibračním módu (EtALd), postupuj takto:  Stiskni tlačítko confirm, zobrazí se 5 cc, vlož pomůcku č.:7, průměr Mini. Stiskni tlačítko confirm, zobrazí se 10 ccL/5 ccH, vlož pomůcku č.:7, průměr Max Stiskni tlačítko confirm, zobrazí se 20 ccL/10 ccH, vlož pomůcku č.:6, průměr Mini Stiskni tlačítko confirm, zobrazí se 20 ccH, vlož pomůcku č.:6, průměr Max Stiskni tlačítko confirm, zobrazí se 50 ccL, vlož pomůcku č.:5, průměr Mini Stiskni tlačítko confirm, zobrazí se 50 ccH, vlož pomůcku č.:5, průměr Max Stiskni tlačítko confirm, pumpa se nastaví do kalibračního módu (EtAL d).	
	Po kalibraci provedte ověření (tEStF) velikostí stříkaček.	
10.	Kontrola seznamu stříkaček v paměti a na panelu přístroje (tEStH)	<input checked="" type="checkbox"/>
11.	Funkční kontrola - kontrola vnějších krytů a stavu síťové šňůry	<input checked="" type="checkbox"/>
12.	Kontrola antisifonu - kontrola funkce antisifonu (volnost pohybu, bez nepřipustné vůle) - kontrola alarmu pro horní a spodní polohu - kontrola NO alarm při přítomnosti pomůcek T301454 nebo T301455	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
13.	Kontrola zpětného tlaku (s novou stříkačkou BD Plastipack 50 ccm ) při 120 ml/h. - volba alarmu střední hladiny okluse nebo proměnný mód 0,55< 0,74 bar≤0,75 mm Hg nebo 500+-75 mm Hg	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	Pozn.: spusťte test při zpětném tlaku=0, aby zařízení mohlo inicializovat tlakový senzor při startu infuze	
14.	Kontrola prealarmu a konce infuze - rychlosť podávání 50 ml/h – BD 50 ccm - optický a akustický alarm 5 min. +10 s před alarmem konec infuze	<input checked="" type="checkbox"/>
15.	Kontrola alarmu na konci infuze (BD Plastipack 50 ccm) - přečíst hodnotu polohy pístu (tEStC) 18,5≤ 18,9 mm≤ 19,5 - pokud je mimo toleranci, viz kalibrační mód EtAL6	<input checked="" type="checkbox"/>
16.	Kontrola linearity (BD Plastipack 50 ccm) – rychlosť 50 ml/hod - kontrola polohy pístu 50ml<X<60ml X1- mm X2- mm - rozdíl X1-X2 leží mezi 74,96≤ 76,11 ≤ 76,47	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

17.	Kontrola zámku - připojit Module na Base - připojit Base k napájení - stisknout ON na Module - kontrola, zda je č. Module zobrazeno na Base a na Module - kontrola, zda zobrazené číslo souhlasí s polohou Module na Base - pomalu odpojít Module - kontrola, že se rozsvítí kontrolka „C“  Pokud se objeví nějaká anomálie, postupujte podle „adjusting ILS“ v TM	<input checked="" type="checkbox"/>
18.	Kontrola akumulátoru - nabijte dostatečně akumulátor - test při rychlosti podávání 40 ml/h  Pokud je autonomie menší než 3 hod., vyměň akumulátor. Pozn: akumulátor může ztratit 25 až 50 % své kapacity deklarované výrobcem kvůli svým chemickým článkům z důvodu stáří nebo nepřítomnosti nabíjecích a vybíjecích cyklů.	<input checked="" type="checkbox"/>
19.	Test elektrické bezpečnosti - neutrální vodič a kovový plášť - fáze a kovový plášť	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Příští kontrola datum : 16.10.2009

Datum:	Kontrolu provedl:	Podpis (razítko):
16.10.2008	Miroslav Kubeš	 FRESENIUS MEDICAL CARE Česká republika s.r.o. Lužna 591, 100 05 Praha 6 Tel.: 263 356 212 Děč.: 0245790884 TECHNICKÝ SERVIS -7-

Zdravotnický prostředek je funkční a bezpečný pro použití k výrobcem určenému účelu při poskytování zdravotní péče a je uvolněn k dalšímu používání	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
---	---

Poznámka:		
Datum:	Vystavil:	Podpis (razítko):
16.10.2008	Miroslav Kubeš	 FRESENIUS MEDICAL CARE Česká republika s.r.o. Lužna 591, 100 05 Praha 6 Tel.: 263 356 212 Děč.: 0245790884 TECHNICKÝ SERVIS -7-

**FRESENIUS  
MEDICAL CARE  
ČR - technický  
servis -  
PSEUDONYM**

Digitally signed by FRESENIUS  
MEDICAL CARE ČR - technický  
servis - PSEUDONYM  
DN: cn=FRESENIUS MEDICAL  
CARE ČR - technický servis -  
PSEUDONYM, c=CZ  
Date: 2008.10.16 10:30:35  
+01'00'