

Protokol o periodické prohlídce zdravotnického prostředku dle zákona 346/2003, § 27

Zákazník FN Olomouc

Přístroj Monitor

Typ S/5 Light

Výrobní číslo 4920164

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly.
☒	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
☒	☐	Ovládací prvky, signalizace
☒	☐	Fukční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce
☒	☐	Ověření přesnosti měřících funkcí (kalibrace)
☐	☐	

Bezpečnostní test - měření

Měřená veličina		Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,38 mA	max. 0,5 mA
	Příložná část	0.01 mA	max. 0,05 mA
Izolační odpor		>20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče		0,05 Ω	max 0,2 Ω

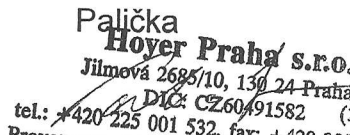
Reference: Servisní výkaz č.65/06..... ze dne9.3.2006.....

Výsledek prohlídky (závěr) : vyhověl

Prověřovaný zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Použitý měřicí přístroj: Meditest 50 v.č. 980447

Technik : Palička Provedeno dne : 9.3.2006

Podpis :  Datum příští kontroly : 3/2007