

Protokol o prověření zdravotnického prostředku dle zákona 346/2003, § 52 , odstavec 4

Zákazník	FN OLOMOUC
Přístroj	I 020459 Monitor
Typ	S/5
Výrobní číslo	5167631

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly.
☒	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
☒	☐	Ovládací prvky, signalizace
☒	☐	Funkční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce
☒	☐	Ověření přesnosti měřících funkcí (kalibrace)
☐	☐	

Bezpečnostní test - měření

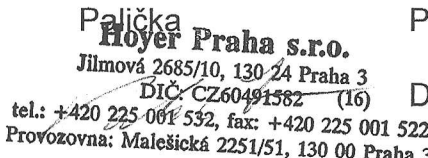
Měřená veličina	Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,06 mA
	Příložná část	0.01 mA
Izolační odpor	>20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče	0,16 Ω	max 0,2 Ω

Reference: Servisní výkaz č.305/06..... ze dne6.11.2006.....

Výsledek prohlídky (závěr) : vyhověl

Prověřovaný zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Použitý měřicí přístroj: Meditest 50 v.č. 980447

Technik :		Provedeno dne :	6.11.2006
Podpis :		Datum příští kontroly :	11/2007