



PROTOKOL O ELEKTRICKÉ KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO PŘÍSTROJE DLE ČES 33. 03. 95

JMENOVITÉ HODNOTY PŘÍSTROJE: $U_n = 230 \text{ V}$ $P_n = 100 \text{ W}$	
TRÍDA OCHRANY: <u>I</u>	
SESTAVA:	
☐	přístroj měřen samostatně (nevypĺňuje se délka (m))
☐	přístroj s pevně připojeným síťovým přívodem o délce.....m
☒	přístroj s odpojitelným síťovým přívodem o délce..... <u>2</u> m
ODPOR OCHRANNÉHO VODIČE (POUZE U PŘÍSTROJŮ TRÍDY I): <u>91</u> ohm	
UNIKAJÍCÍ PROUD:	
☒	síťová část - přístupná část $N = 0,09 \text{ mA}$ $U = 0,02 \text{ mA}$ $R = 0,06 \text{ mA (max 1mA)}$
☒	síťová část - příločná část: $N = 0,056 \text{ mA}$ $U = 0,012 \text{ mA}$ (max 0,5mA)
☒	přístupná část - příločná část $R = 0,007 \text{ mA}$ (max 0,5mA)
POUŽITÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ: MEDITEST 50 ČÍSLO PŘÍSTROJE: 200 324	
VYHOVĚL ZKOUŠCE CHODU: vyhověl - nevyhověl	
VYHOVĚL KONTROLE DLE ČES 33. 03. 95: vyhověl - nevyhověl	
VÝSLEDEK KONTROLY: bez závad závady:	
ZÁVĚR: BYLA PROVEDENA KONTROLA ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ DLE ZÁKONA 346/2003 sb. přístroj vyhovuje - nevyhovuje	
TERMÍN PŘÍSTÍ KONTROLY PŘÍSTROJE: <u>6/2009</u>	
KONTROLU PROVEDL:	
V <u>LIŠOVĚ</u>	DNE <u>9. 6. 2008</u>  podpis
POTVRZENÍ ORGANIZACE:	

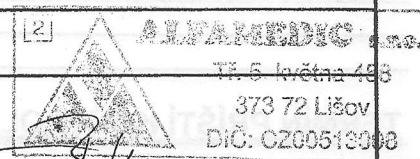

PROTOKOL O KONTROLE ZDRAVOTNICKÝCH PŘÍSTROJŮ DLE ZÁKONA 346/2003 sb. § 52

[illegible]

VÝSLEDEK KONTROLY:

VYHOVUJE - NEVYHOVUJE

TERMÍN PŘÍŠTÍ KONTROLY:

6/2009

EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20080544