

Protokol o prověření zdravotnického přístroje dle zákona 346/2003, § 52, odstavec 4

Zákazník FD GLOMOC  
URO

Přístroj UB GENERATOR

Typ 2271, 001

Výrobní číslo M00000343

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené testy, zkoušky, měření.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Funkční kontrola
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Test ovládacích tlačítek
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kontrola nastavení

**Bezpečnostní test - měření**

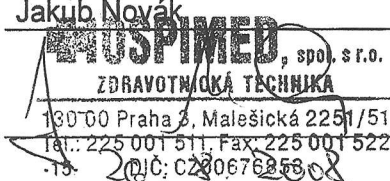
Měřená veličina	Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,25 mA
	Příložná část	0,008 mA
Izolační odpor	>20 MΩ	min. 6 MΩ
Odpor ochranného vodiče	0,11 Ω	max 0,3 Ω

Výsledek prohlídky (závěr) :

Vlastnosti přístroje odpovídají technickým parametrům předepsaným výrobcem. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče.

Použité měřicí přístroje:

Meditest 50	v.č.	200 047
Surgicase-20	v.č.	9910CE165 Z0904

Technik	Jakub Novák
Podpis technika	
Datum kontroly	20.11.2008
Další prověření dle § 27 zákona č. 346/2003 Sb.	