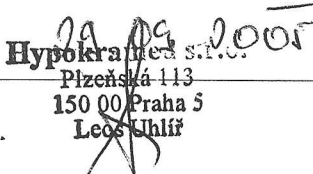


ZPRÁVA O REVIZI č.		01	
		NS	
zodpovědný pracovník			
umístění		OPL	
termín příští revize		29.09.2006	
Revize el. zdrav. přístroje napojeného pohyblivým přívodem - dle dle ČSN EN 60601-1 a Doporučení ČES 33. 03. 95			
Staniční sestra:		Datum:	
Protokol vypracoval:	Ing. Oldřich Zoubek	Třída ochrany:	IB
Revizi provedl:	L. UHLÍŘ		
Název přístroje:	op. stůl	Jmen. napětí V:	230
Typ přístroje:	123.02CO	Inv. číslo:	018453
Výrobce:	MAQUET	Výr. číslo:	Nr: 00150
Rok výroby:	1999	Jmenovitý výkon:	
Návod k obsluze a dokumentace jsou uloženy u zodpovědného pracovníka oddělení			
Měření		Mezní hodnoty	Naměřené hodnoty
Odpor ochranného vodiče:	(ohmů)	0,2 (0,3)	0,14 Ω
Přechodový odpor PA	(ohmů)	0,1	0,04 Ω
Izolační odpor:	(Mohmů)	7 (2)	> 20 MΩ
Unikající proud I_{u1} - do země	(mA)	1 (3,5)	0,01 mA
Unikající proud I_{u2} - krytem	(mA)	1	0,015 mA
Unikající proud I_{u3} - příl.	(mA)	0,5	-
Použitý měřicí přístroj:	MEDITEST č. 200344 kal. č. 00134/1M50		
Revize, zkouška a kontrola byla provedena dle pož. ČSN EN 60601-1 a Doporučení ČES 33. 03.95			
Kontrola funkce a bezpečnosti přístroje:	<u>BEZ ZÁVAD</u>		
PODLE PROVEDENÉ REVIZE JE PŘÍSTROJ SCHOPEN BEZPEČNÉHO PROVOZU			
Závada:			
Termín odstranění			
Závadu odstranil:			
Datum, podpis:	 Hypokramed s.r.o. Plzeňská 113 150 00 Praha 5 Leoš Uhlíř		
Podpis technika:			
Podpis, razítko:	Ing. Oldřich Zoubek revizní technik elektro Vajdova 10, 102 00 Praha 10 ev. č. 11848/2/96/EZ-M,O,R-S 