


A DEVENT. PROHL.

II

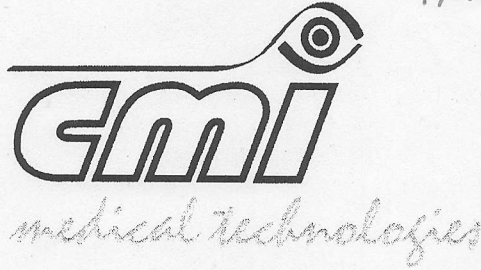

Protokol
o bezpečnostně technické kontrole
zdravotnického prostředku (ZP) – přístroje
 V souladu se Zákonem 123/2000 Sb. § 52.

Poskytovatel zdravotní péče: Fakultní nemocnice Olomouc

Umístění ZP: oční klinika, ambulance

Inv.č.:C004566-000

Název ZP:štěrbinová lampa

Typ: CSO SL990 3X

Výrobce: CSO

Výr.č.: 04030037

Druh kontroly a měření	---	Výsledek	---	Poznámka
stav mechanických funkcí a částí		vyhovuje / nevyhovuje	
stav elektrických a elektronických funkcí a částí		vyhovuje / nevyhovuje	
stav optiky		vyhovuje / nevyhovuje	
kontrola el. bezpečnosti Meditest 50 – v.č.: 204027		vyhovuje / nevyhovuje		odpor ochranného uzemňovacího vodiče 0,25Ohm hodnota izolačního odporu >20 Mohm

Celkový stav přístroje vyhovuje / ~~nevyhovuje~~ pro použití k výrobcem stanovenému účelu při poskytování zdravotní péče a je / ~~není~~ funkční a bezpečný.

Termín následné kontroly: 5.6.2009

Zhotovitel: CMI, s.r.o.

Kontrolu provedl dne: 5.6.2008


 CMI s.r.o.
 Meleco Centre Office Park
 Sokolovská 100/94
 Petr Sixta, 480 00 Praha 8
 Iměno a pošta: 471 7 20
 www.cmi.sk | DIČ: CZ47117320