

ZPRÁVA O PRAVIDELNÉ REVIZI ZDRAVOTNICKÉHO EL. PŘÍSTROJE

Datum revize 15.6.2007
Datum předání zprávy 18.6.2007

Číslo revize 3888 - 07/052 P

PŘÍSTROJ

Název
Typ
Výrobce
Výrobní číslo
Evidenční číslo
Třída ochrany / typ přístroje

PŘÍSTROJ INHALAČNÍ KOMPRESOROVÝ
PARI BOY, 37.00
Pari GmbH, D
BBY3BA0096
D038080-000
II / B

REVIZNÍ TECHNIK

Petr Tichý, 3088/9/04/R-EZ-E2/B

PROVOZOVATEL

Ústav

Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 6,
Olomouc, 775 20, TRN lůžkové odd.

NAMĚŘENÉ HODNOTY

Izolační odpor R_{IZOL} >20 M Ω
Unikající proud síť. část - přístup. části <0,01 mA / P

POZNÁMKA


Měření bylo provedeno dle ČES 33.03.95, použitý měřicí přístroj Meditest 50, 703050
Použitý přístroj má platnou kalibraci a byl před použitím zkontrolován

CELKOVÝ POSUDEK

Revize byla provedena v souladu s ČSN 33 1500, ČSN EN 60601-1, ČES 33.03.95
a souvisejícími.

El. přístroj je dle ČSN 33 1500, příloha A

SCHOPEN BEZPEČNÉHO PROVOZU

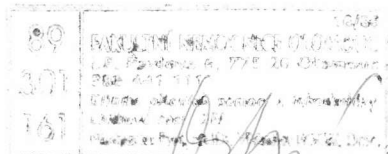

provozovatel



rev. technik