


Kontrola homogenity scintilační kamery NUCLINE PAC S/n: PAC-X05084-CO

**Klinika nukleární medicíny
Fakultní nemocnice v Olomouci**

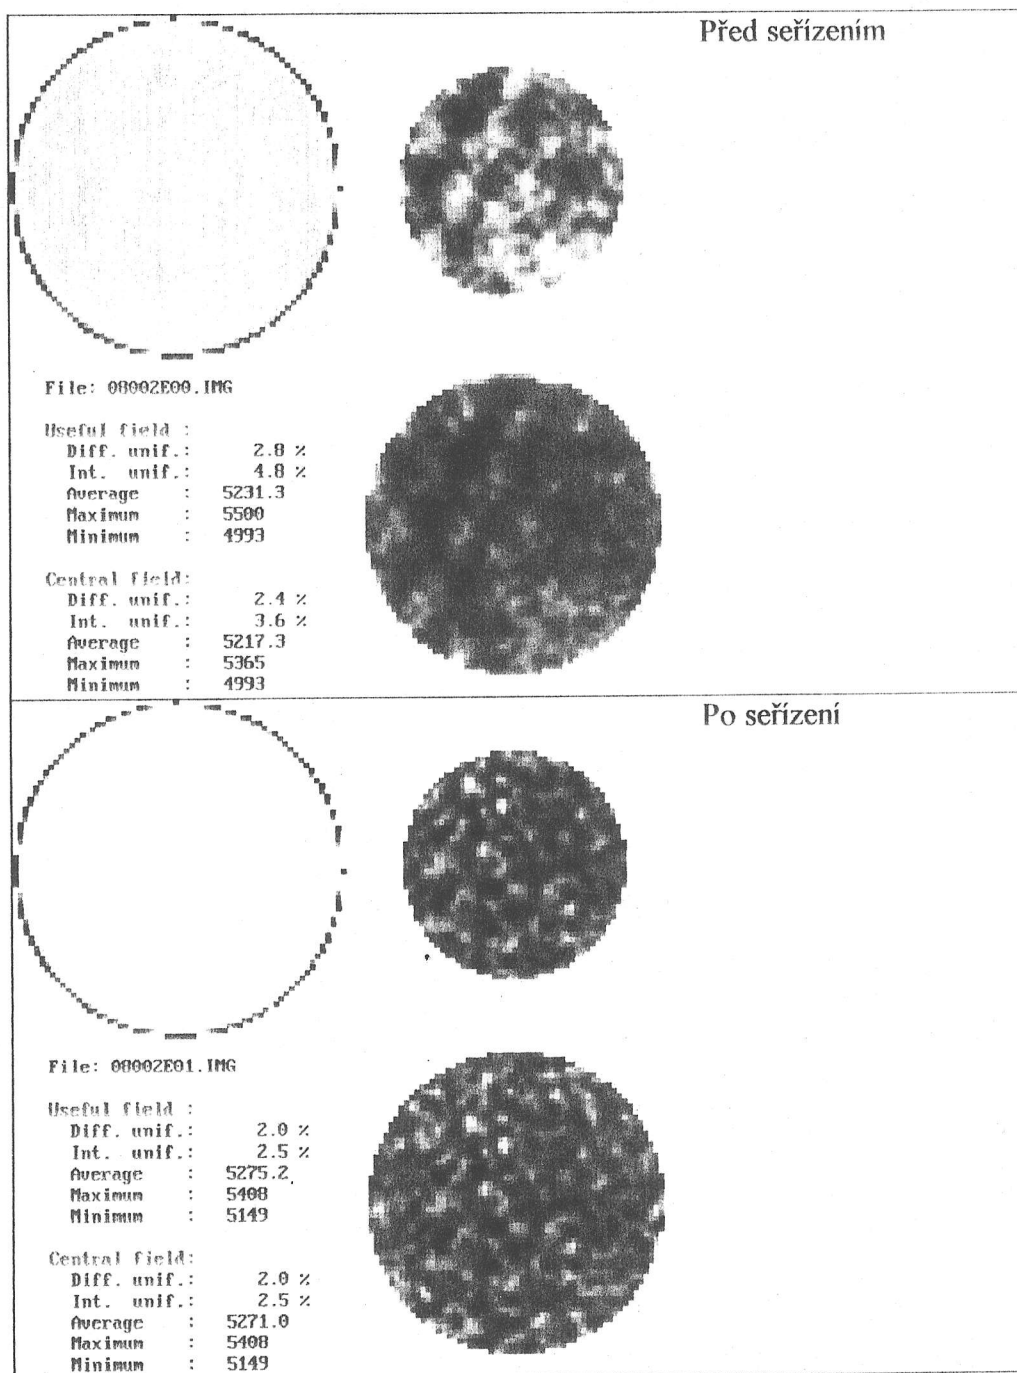

Poznámka :

Měření bylo provedeno dne : 17.1.2008 17:22

Podpis (za pracoviště):

Podpis (za BANK.SYS.) :

měření provedl a zpracoval:
Ing Dubroka Ladislav