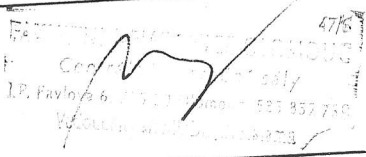


# PROTOKOL O ELEKTRICKÉ KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO PŘÍSTROJE DLE ČES 33. 03. 95

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JMENOVITÉ HODNOTY PŘÍSTROJE: $U_n = 230 \text{ V}$ $P_n = 100 \text{ W}$                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |
| TRÍDA OCHRANY: <u>II</u>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |
| SESTAVA:                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> přístroj měřen samostatně (nevyplňuje se délka (m))                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> přístroj s pevně připojeným síťovým přívodem o délce.....m                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> přístroj s odpojitelným síťovým přívodem o délce.....m                                                                                                                      |
| ODPOR OCHRANNÉHO VODIČE (POUZE U PŘÍSTROJŮ TŘÍDY I): <u>                    </u> ohm                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |
| UNIKAJÍCÍ PROUD:                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> síťová část - přístupná část<br>$N = 0,00 \text{ mA}$ $U = 0,00 \text{ mA}$ $R = 0,01 \text{ mA (max 1mA)}$                                                      |
|                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> síťová část - příložná část<br>$N = 0,015 \text{ mA}$ $U = 0,002 \text{ mA}$ (max 0,5mA)                                                                         |
|                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> přístupná část - příložná část<br>$R = 0,006 \text{ mA}$ (max 0,5mA)                                                                                             |
| POUŽITÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ: MEDITEST 50 ČÍSLO PŘÍSTROJE: 200 324                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |
| VYHOVĚL ZKOUŠCE CHODU: <span style="float: right;">vyhověl - <del>nevyhověl</del></span>                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |
| VYHOVĚL KONTROLE DLE ČES 33. 03. 95: <span style="float: right;">vyhověl - <del>nevyhověl</del></span>                                                           |                                                                                                                                                                                                      |
| VÝSLEDEK KONTROLY: bez závad<br><del>závady:</del>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |
| ZÁVĚR: BYLA PROVEDENA KONTROLA ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ DLE<br>ZÁKONA 346/2003 sb. <span style="float: right;">přístroj vyhovuje - <del>nevyhovuje</del></span> |                                                                                                                                                                                                      |
| TERMÍN PŘÍŠTÍ KONTROLY PŘÍSTROJE: <u>7/2007</u>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |
| KONTROLU PROVEDL:                                                                                                                                                | <div style="text-align: right;"> <br/>             DNE <u>24.9.2006</u><br/>             podpis           </div> |
| V <u>Olomouček</u>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |
| POTVRZENÍ ORGANIZACE:                                                                                                                                            |                                                                                                                   |

**IP. PAVLOV s.r.o.**  
 Tř. 5. května 458  
 373 72 Lišov  
 DIČ: CZ00513008