

Protokol o provedení periodické prohlídky

**Servisní prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídající požadavkům
zákona 123/2000Sb. v platném znění**

Zákazník	FN OLOMOUC I.P.Pavlova 6 775 20 Olomouc	Kardiochirurgická klinika-JIP 50A
Přístroj Typ	Centrála CIC V4.08	
Výrobní číslo	L13F0682G	
Inventární číslo	IO19819-000	

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly.
☐	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
☐	☐	Ovládací prvky, signalizace

Bezpečnostní test - měření

Měřená veličina		Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,46 mA	max. 0,5 mA
Izolační odpor		> 20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče		0,10 Ω	max 0,2 Ω

Výsledek prohlídky (závěr) :

Parametry přístroje odpovídají hodnotám předepsanými výrobcem. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče.


Použité měřicí přístroje:

Meditest 50 v.č. 204 028	

Technik : Jan Balhárek

Provedeno dne : 22.11.2007

Podpis :

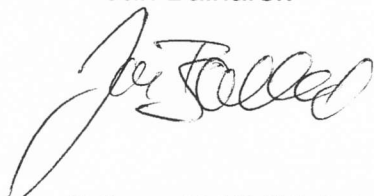

Datum příští kontroly : Po jednom roce