

Protokol o provedení periodické prohlídky

Servisní prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídající požadavkům zákona 123/2000Sb. v platném znění

Zákazník	FN OLOMOUC, Kardiochirurgická klinika, JIP		
	I.P.Pavlova 6, 775 20, Olomouc		
Přístroj	EKG		
Typ	MAC 5000		
Výrobní číslo	M1MP7192P	Inventární číslo	IO19764-000

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené testy, zkoušky, měření.
x	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
x	☐	Auto test po zapnutí
x	☐	Test ovládacích tlačítek
x	☐	Test EKG obvodů, zobrazení amplitudy a periody QRS
x	☐	Test tiskárny
		Bezpečnostní test – měření

Měřená veličina		Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,05 mA	max. 0,5 mA
	Příložná část	0,006 mA	max. 0,05 mA
Izolační odpor		>20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče		0,06 Ω	max 0,2 Ω

Výsledek prohlídky (závěr) :

Parametry přístroje odpovídají – ~~neodpovídají~~ hodnotám předepsaným výrobcem.
 Zkontrolovaný přístroj je – ~~není~~ plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče.


Použité měřicí přístroje:

Meditest 50 v.č. 204 028	
--------------------------	--

Technik : Jan Balhárek

Provedeno dne : 3.8.2007

Podpis :

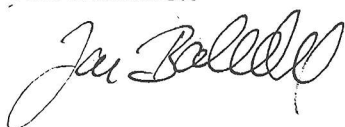

Datum příští kontroly : Po jednom roce