

## Protokol o provedení periodické prohlídky

**Servisní prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídající požadavkům zákona 123/2000Sb. v platném znění**

<b>Zákazník</b>	FN OLOMOUC I.P.Pavlova 6 775 20 Olomouc	Kardiologická klinika-JIP 50B
<b>Přístroj</b>	Monitor životních funkcí	
<b>Typ</b>	DASH 4000	
<b>Výrobní číslo</b>	K1DJ5029G	
<b>Inventární číslo</b>	IO19815-000	

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly.
x	<input type="checkbox"/>	<b>Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)</b>
x	<input type="checkbox"/>	Ovládací prvky, signalizace
x	<input type="checkbox"/>	Displeje
x	<input type="checkbox"/>	Kalibrace NIBP
		<b>Bezpečnostní test - měření</b>

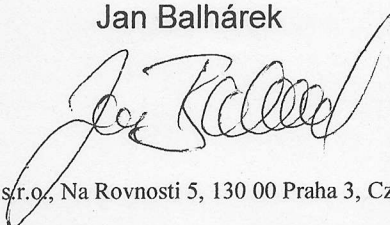
Měřená veličina		Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,40 mA	max. 0,5 mA
	Příložná část	0,007 mA	max. 0,05 mA
Izolační odpor		>20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče		0,06 Ω	max 0,2 Ω

Výsledek prohlídky (závěr) :

Parametry přístroje odpovídají – ~~neodpovídají~~ hodnotám předepsanými výrobcem. Zkontrolovaný přístroj je – ~~není~~ plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče.

Použité měřicí přístroje:

Meditest 50 v.č. 204 028	
--------------------------	--

Technik :	Jan Balhárek	Provedeno dne :	22.11.2007
Podpis :		Datum příští kontroly :	Po jednom roce