

Protokol o provedení periodické prohlídky

Servisní prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídající požadavkům zákona 123/2000Sb. v platném znění

Zákazník	FN OLOMOUC I.P.Pavlova 6 775 20 Olomouc	Kardiochirurgická klinika-JIP 50B
Přístroj	Monitor životních funkcí	
Typ	DASH 4000	
Výrobní číslo	K1DJ5691G	
Inventární číslo	IO19813-000	

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly.
x	<input type="checkbox"/>	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
x	<input type="checkbox"/>	Ovládací prvky, signalizace
x	<input type="checkbox"/>	Displeje
x	<input type="checkbox"/>	Kalibrace NIBP
Bezpečnostní test - měření		

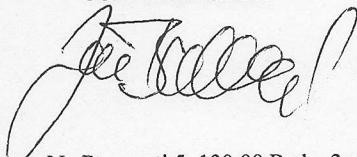
Měřená veličina	Naměřeno	Limit	
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,44 mA	max. 0,5 mA
	Příložná část	0,007 mA	max. 0,05 mA
Izolační odpor	>20 MΩ	min. 20 MΩ	
Odpor ochranného vodiče	0,07 Ω	max 0,2 Ω	

Výsledek prohlídky (závěr) :

Parametry přístroje odpovídají – ~~neodpovídají~~ hodnotám předepsanými výrobcem. Zkontrolovaný přístroj je – ~~není~~ plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče.

Použité měřicí přístroje:

Meditest 50 v.č. 204 028	
--------------------------	--

Technik :	Jan Balhárek	Provedeno dne :	22.11.2007
Podpis :		Datum příští kontroly :	Po jednom roce