

Protokol o provedení periodické prohlídky

Servisní prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídající požadavkům zákona 123/2000Sb. v platném znění

Zákazník	FN OLOMOUC, Kardiochirurgická klinika	
Přístroj	I.P.Pavlova 6, 775 20, Olomouc	
	Telemetrický systém	
Typ	APEX PRO	
Výrobní číslo	J1AU0056G	Inventární číslo: IO19821

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly.
x	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
x	☐	Ovládací prvky, signalizace
Bezpečnostní test - měření		

Měřená veličina	Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,32 mA
		max. 0,5 mA
Izolační odpor	> 20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče	0,10 Ω	max 0,2 Ω

Výsledek prohlídky (závěr) :

Parametry přístroje odpovídají hodnotám předepsanými výrobcem. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče.


Použité měřicí přístroje:

Meditest 50 v.č. 204 028	

Technik : Jan Balhárek

Provedeno dne : 25.1.2008

Podpis :

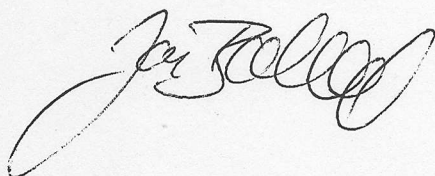

Datum příští kontroly : Po jednom roce