



BMT
Brněnská Medicinská
Technika a.s.
MMM-Group

Protokol o měření teploty

PŘÍLOHA 2
QSM 10-01
Strana 1/1

Výrobce:

BMT a.s.

Typ přístroje:

☐ VENTICELL
☐ FRIOCELL

☐ ECOCELL
☐ CLIMACELL

☒ INCUCELL
☐ STERICELL

☐ INCUCELL V
☐ DUROCELL

☐ VACUCELL

Objem [l]:

☐ 22

☒ 55

☐ 111

☐ 222

☐ 404

☐ 707


Výrobní číslo přístroje:

02 0982

Datum měření:

3.5.2002

Všeobecné měřicí podmínky:

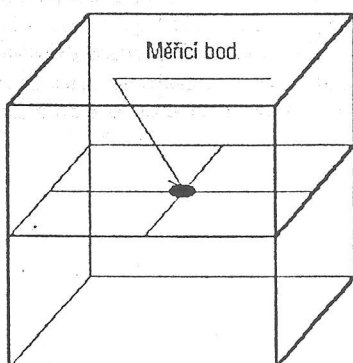

- Porovnání údaje o teplotě zobrazené displejem regulátoru zařízení se skutečnou hodnotou naměřenou uvnitř komory probíhá v souladu s požadavky modelu zabezpečování jakosti při návrhu, vývoji, výrobě, instalaci a servisu ČSN EN ISO 9001.
- Referenční měřidlo použité při měření je v souladu se směrnici systému jakosti QSM 11-01 Řízení kontrolního, měřicího a zkušebního zařízení a ve shodě se Zákonem č. 505/1990 Sb. o metrologii, Vyhláškou č. 69/1991 Sb., kterou se Zákon o metrologii provádí a Vyhláškou č. 231/1993 Sb., kterou se mění a doplňuje Vyhláška č. 69/1991 Sb. pravidelně kalibrováno podle prováděcího schématu návaznosti měřidel porovnáním s pracovním etalonem teploty společnosti a případné korekce pak při měření zohledněny.
Pracovní etalon je navázán na národní etalon prostřednictvím etalonů teploty akreditovaných kalibračních laboratorů.

Referenční podmínky měření:

- Teplota okolí 23 ± 3 °C.

Referenční měřidlo:

Měřicí zapisovač YOKOGAWA HR 3081 v.č. 47SB0881

Teplotní čidlo - odporový snímač Pt 100 ev.č.

P5A

Tabulka naměřených a vypočtených hodnot:

Teplota [°C]		Odchylka	
Zobrazená hodnota	Naměřená hodnota	[°C]	[%]
40	40	0	0
70	70	0	0

Poznámky

Měření provedl a za úplnost protokolu odpovídá:

Datum

3.5.2002

Jméno, příjmení

Olga Lhotecká

Podpis, razítko



BMT a.s.

Výstupní kontrola

Cejl 48/50, 656 60 Brno

Dič. 288 463 469 96

MMM GROUP

(49)